2025-09-19
Reviderad: 2026-01-08

Handläggare: Patricia Bengtsson

# Vägledning vid förskrivning av sittdynor

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.”
– Utdrag från ”Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län.”.

När begagnat, lagerhållet sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Vägledningen innehåller B-hjälpmedel dvs mindre hjälpmedel som tillhandahålls via respektive kommuns buffertförråd. Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS samverkansområde. Sortimentsgruppen har därför valt att inte ha med det begagnade sortimentet av B-hjälpmedel i vägledningen.

**KHS**
**(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län)**
Franska vägen 10
393 56 Kalmar

khs@kalmar.se
www.kalmar.se

Besöksadress Kalmar
Franska vägen 10
Besöksadress Västervik
Timmergatan 2

## Inledning

Från och med 1 oktober år 2025 gäller ett nytt avtal på sittdynor enligt ISO 18 10 06 Sittdynor och ISO 04 33 03 Sittdynor för trycksårsprevention och. Förskrivningsanvisningar med råd inför förskrivningsprocessen hittar ni på KHS hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er patient.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter, alltså inte leverantörernas övriga produkter. Mer information finns på Hjälpmedelstjänsten (länk hittar ni i Visma webSESAM) och leverantörernas hemsidor:

www.bimasweden.se
www.careofsweden.se
www.invacare.se
www.permobil.com
www.nimacare.se

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Förenklad avtalsinformation: Sittdynor

**Avtalsnamn: Sittdynor - länsgemensam**

**Avtalsnummer: U-152-2024**

**Avtalstid: Träder i kraft 2025-10-01 och gäller till och med 2027-08-31.**

**Avtal har tecknats med nedanstående firmor:**

B.i.m.a. Plastteknik AB
Care of Sweden AB
Invacare AB
Permobil Aktiebolag
NIMACARE AB

| Hjälpmedel | Produkt | Leverantör |
|---|---|---|
| **Basdyna** | Bima Duo | B.i.m.a Plastteknik |
| **Tryckfördelande sittdyna** | Contur | Care of Sweden |
| **Förpositionerande sittdyna** | Roho Airlite | Permobil |
| **Tryckfördelande och positionerande sittdynor**<br>Luftfylld dyna i kombination med annat material<br><br>Dyna av skum eller motsvarande material, dock ej luft | <br>Vicair Active O2 9cm<br><br>Matrx Libra | <br>Invacare<br><br>Invacare |
| **Tryckavlastande och positionerande sittdynor**<br>Luftfylld dyna utan separat pump<br><br>Luftfylld dyna med separat pump | <br>Vicair Vector O2 10cm<br><br>Roho Quadtro Select | <br>Invacare<br><br>Permobil |
| **Coxit, dyna** | Coxit ¼ urtag<br>Coxit ½ urtag | Nimacare |
| **Utjämningsskiva** | Utjämningsplatta, Curera | Care of Sweden |

Samtliga sittdynor är upphandlade i storlek 35x35-50x50cm
(Basdynan: till 50x45cm).

Vid frågor gällande denna upphandling hänvisas ni till sortimentsgruppen:
Länk till Sortimentsgruppen.

Tillbaka till Innehållsförteckning

## Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på hyperlänken

Förenklad avtalsinformation:  Sittdynor

**Enkla sittdynor:**

1. Basdyna
2. Tryckfördelande sittdyna
3. Förpositionerande sittdynor

**Avancerade sittdynor:**

Tryckfördelande och positionerande sittdynor

4. Luftfylld dyna i kombination med annat material
5. Dyna av skum eller motsvarande material, dock ej luft

Tryckavlastande och positionerande sittdynor

6. Luftfylld dyna utan separat pump
7. Luftfylld dyna med separat pump

**Övriga sittdynor och tillbehör**

8. Dyna typ Coxit L1
9. Utjämningsskiva

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Basdyna

## Avsedd användning

Patienten sitter på sin dyna kortare stunder, ibland upp till större delen av dagen. Patienten kan själv ändra läge/position i sitt sittande.

## Egenskaper

Sittdynan jämnar ut tryck mot känsliga kroppsdelar på sittytan genom sin form. Färdig att använda från förpackning. Sittdynan finns med kupad botten för hängmattesits och planbotten för plansits.

## Avtalad produkt

Produktnamn: Bima duo
Leverantör:
B.i.m.a. Plastteknik AB

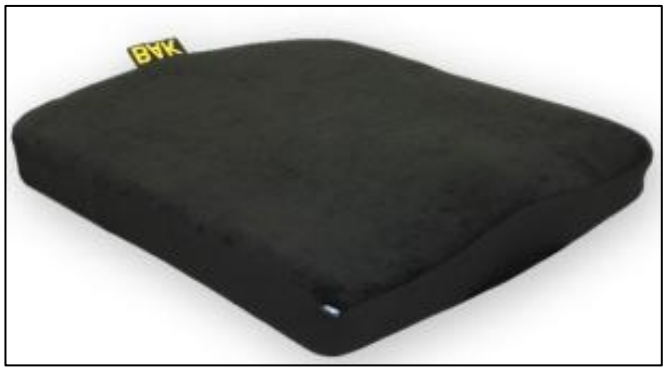


## Standardutförande

Sittdyna med plyschöverdrag

## Tillbehör

Inkontinensöverdrag

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring |
|---|---|---|
| 6,5 cm | Sb 35-37cm: 100kg<br>Sb 40-42cm: 125kg<br>Sb 45-50: 135kg | Standardöverdrag tvättas i max 60ºC.<br>Skumbas rengörs med ytdesinfektion. |

| **Sittdyna inkl standardöverdrag** | **Kupad botten Artnr VwS** | **Plan botten Artnr VwS** |
|---|---|---|
| Sittdyna Bima duo plysch 35x40/43x6,5cm | 33667 | 49781 |
| Sittdyna Bima duo plysch 40x40/43x6,5cm | 33677 | 49784 |
| Sittdyna Bima duo plysch 40x45/48x6,5cm | 41670 | 49785 |
| Sittdyna Bima duo plysch 45x40/43x6,5cm | 33676 | 49788 |
| Sittdyna Bima duo plysch 45x45/48x6,5cm | 33685 | 49789 |
| Sittdyna Bima duo plysch 50x45/48x6,5cm | 33707 | 33806 |

| **Inkontinensöverdrag i inkofrotté** | **Artikelnr VwS, kupad** | **Artikelnr VwS, plan** |
|---|---|---|
| 35x40/43x6,5cm | 49799 | 49811 |
| 40x40/43x6,5cm | 49802 | 49814 |
| 40x45/48x6,5cm | 49803 | 49815 |
| 45x40/43x6,5cm | 49806 | 49819 |
| 45x45/48x6,5cm | 49807 | 49820 |
| 50x45/48x6,5cm | 49810 | 49817 |

OBS! Sittdynorna finns i fler storlekar än de som presenteras i vägledningen.

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Tryckfördelande sittdyna

## Avsedd användning

Patienten är tryck- och/eller smärtkänslig. Patienten behöver avlastning för att förhindra att trycksår eller smärta uppstår. Patienten kan i de flesta fall ändra läge/position i sitt sittande.

## Egenskaper

Sittdynan jämnar ut tryck mot känsliga kroppsdelar på sittytan genom sin form och material. Sittdynan är av mjukskum med viscoelastiskt skum i nedre delen av sittgropen. Med urtag för ryggrör. Har ett ytskikt som inte släpper igenom vätskor. Färdig att använda från förpackning.

## Avtalad produkt

Produktnamn: Curera® Contur
Leverantör: Care of Sweden AB

## Standardutförande

Sittdyna med plyschöverdrag

## Tillbehör

Inkontinensöverdrag

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring |
|---|---|---|
| 5 cm | Sb 35-42cm: 125kg<br>Sb 45: 135kg<br>Från 47x45cm: 150kg | Standardöverdrag tvättas i max 95ºC.<br>Skumbas rengörs med ytdesinfektionsmedel. |

| Sittdyna inkl standardöverdrag | Artikelnr VwS nr | Artikelnr VwS inkontinensöverdrag |
|---|---|---|
| Sittdyna Contur 35x35cm | 32377 | 49748 |
| Sittdyna Contur 35x40cm | 32378 | 49749 |
| Sittdyna Contur 40x40cm | 32382 | 49751 |
| Sittdyna Contur 40x45cm | 32383 | 49824 |
| Sittdyna Contur 45x40cm | 32386 | 49755 |
| Sittdyna Contur 45x45cm | 32023 | 49826 |
| Sittdyna Contur 40x50cm | 32399 | 49752 |
| Sittdyna Contur 45x50cm | 32387 | 49756 |
| Sittdyna Contur 50x45cm | 32389 | 49759 |
| Sittdyna Contur 50x50cm | 32390 | 49760 |

OBS! Sittdynorna finns i fler storlekar än de som presenteras i vägledningen.

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Förpositionerande sittdynor

## Avsedd användning

Patienten sitter på dynan större delen av dagen. Patienten kan inte aktivt ändra läge/position i sittande. Patienten behöver stöd/god positionering för att bibehålla ett funktionellt sittande.

## Egenskaper

Sittdyna som ger god positionering och fördelar tryck över sittytan genom sin form och material. Sittdynan är av mjukskum med en tydlig sittgrop med inbyggd luft-sektion (ROHO air floatation™) som motverkar framåtglidande och ger ett stabilt upprätt sittande. Har ett ytskikt som inte släpper igenom vätskor. Färdig att an-vända från förpackning.

## Avtalad produkt

Produktnamn: ROHO® AirLITE
Leverantör: Permobil AB

## Standardutförande

Sittdyna med inkontinensöverdrag

## Tillbehör

Inkontinensöverdrag

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring |
|---|---|---|
| 5-9,5cm | 136kg | Standardöverdrag tvättas i max 30ºC.<br>Skumbas rengörs med ytdesinfektionsmedel. |

| Sittdyna inkl inkontinensöverdrag | Artikelnr VwS | Artikelnr VwS inkontinensöverdrag |
|---|---|---|
| Sittdyna ROHO Airlite 35,5x35,5cm | 43188 | 43456 |
| Sittdyna ROHO Airlite 35,5x40,5cm | 43189 | 43457 |
| Sittdyna ROHO Airlite 40,5x40,5cm | 43192 | 43458 |
| Sittdyna ROHO Airlite 40,5x45,5cm | 43193 | 43459 |
| Sittdyna ROHO Airlite 45,5x40,5cm | 43196 | 43461 |
| Sittdyna ROHO Airlite 45,5x45,5cm | 43197 | 43462 |
| Sittdyna ROHO Airlite 45,5x51cm | 43198 | 43463 |
| Sittdyna ROHO Airlite 51x45,5cm | 43202 | 43464 |

OBS! Sittdynorna finns i fler storlekar än de som presenteras i vägledningen.

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Tryckfördelande och positionerande sittdynor

## 1. Luftfylld dyna i kombination med annat material

### Avsedd användning

Patienten sitter på dynan större delen av dagen. Patienten kan inte aktivt ändra position i sittande. Patienten kan behöva individuella anpassningar för att uppnå och bibehålla ett funktionellt sittande. Patienten är tryck- och/eller smärtkänslig

### Egenskaper

Sittdyna som ger god positionering och fördelar tryck över sittytan genom sin form och material. Sittdynan kan anpassas manuellt för att kompensera eller korrigera deformitet eller funktionsbortfall hos patienten. Sittdynan är av skum i främre halvan och fyra (4) fack med luftinlägg (SmartCells™) i bakre halvan. Det luftgenomsläpplig överdraget gör att läckage rinner igenom sittdynan och skapar gott mikroklimat för huden. Sittdynan kan användas färdig från förpackning. Avståndet mellan sittbensknöl och sitsbotten ska vara minst 2,5cm, kontrolleras efter 5 minuters sittande.

### Avtalad produkt

Produktnamn: Vicair Active O2 9cm
Leverantör: Invacare AB

### Standardutförande

Sittdyna med luftgenomsläppligt standardöverdrag

### Tillbehör

Inkontinensöverdrag

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring | Rekommendation |
|---|---|---|---|
| 9cm | 200kg | Dyna och överdrag tvättas i max 60ºC, utan skuminlägg.<br>Skuminlägg rengörs med desinfektion. | Puffa upp dynan varje dag före användning. |

| Sittdyna inkl standardöverdrag | Artikelnr VwS | Artikelnr VwS inkontinensöverdrag |
|---|---|---|
| Sittdyna Vicair Active O2 35x35x9cm | 49762 | 43272 |
| Sittdyna Vicair Active O2 35x40x9cm | 49763 | 43264 |
| Sittdyna Vicair Active O2 38x40x9cm | 49764 | 49793 |
| Sittdyna Vicair Active O2 40x40x9cm | 49766 | 43265 |
| Sittdyna Vicair Active O2 40x45x9cm | 49767 | 42198 |
| Sittdyna Vicair Active O2 43x40x9cm | 49768 | 49795 |
| Sittdyna Vicair Active O2 43x45x9cm | 49769 | 47031 |
| Sittdyna Vicair Active O2 45x40x9cm | 49770 | 43268 |
| Sittdyna Vicair Active O2 45x45x9cm | 49771 | 42584 |
| Sittdyna Vicair Active O2 45x50x9cm | 49772 | 43269 |
| Sittdyna Vicair Active O2 48x45x9cm | 49773 | 49797 |
| Sittdyna Vicair Active O2 50x50x9cm | 49780 | 43271 |

Tillbaka till Innehållsförteckning

## 2. Dyna av skum eller motsvarande material, dock ej luft

### Avsedd användning

Patienten sitter på dynan större delen av dagen. Patienten kan inte aktivt ändra position i sittande. Patienten kan behöva individuella anpassningar för att uppnå och bibehålla ett funktionellt sittande. Patienten är tryck- och/eller smärtkänslig

### Egenskaper

Sittdyna som ger god positionering och fördelar tryck över sittytan genom sin form och material. Sittdynan kan anpassas manuellt för att kompensera eller korrigera deformitet eller funktionsbortfall hos patienten. Sittdynan är av mjukt skum och sittgropen har två lagers silikonbaserat gelinlägg (Flo-tech™) som är självutjämnande. Sittdynan kan användas färdig från förpackning.

### Avtalad produkt

Produktnamn: Matrx Libra®
Leverantör: Invacare AB

### Standardutförande

Sittdyna med luftgenomsläppligt överdrag

### Tillbehör

Inkontinensöverdrag, Positioneringsdelar/kilar

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring |
|---|---|---|
| 7cm | 136kg | Standardöverdrag tvättas i max 80°C.<br>Skumbas rengörs med ytdesinfektionsmedel. |

| Sittdyna inkl standardöverdrag | Artikelnr VwS | Artikelnr VwS inkontinensöverdrag |
|---|---|---|
| Sittdyna MatrX Libra 36x36cm | 43205 | 43231 |
| Sittdyna MatrX Libra 36x41cm | 43206 | 43232 |
| Sittdyna MatrX Libra 38x41cm | 43450 | 43446 |
| Sittdyna MatrX Libra 38x46cm | 43451 | 43447 |
| Sittdyna MatrX Libra 41x41cm | 42281 | 43233 |
| Sittdyna MatrX Libra 41x46cm | 42282 | 43234 |
| Sittdyna MatrX Libra 43x41cm | 43452 | 43448 |
| Sittdyna MatrX Libra 43x46cm | 43453 | 43449 |
| Sittdyna MatrX Libra 46x41cm | 43208 | 43236 |
| Sittdyna MatrX Libra 46x46cm | 43209 | 43237 |
| Sittdyna MatrX Libra 46x51cm | 43210 | 43238 |
| Sittdyna MatrX Libra 48x46cm | 43212 | 43240 |
| Sittdyna MatrX Libra 48x51cm | 43213 | 43241 |
| Sittdyna MatrX Libra 51x46cm | 43215 | 43243 |
| Sittdyna MatrX Libra 51x51cm | 43216 | 43244 |

Tillbaka till Innehållsförteckning

| Tillbehör | Artikelnr VwS |
|---|---|
| Grendelare sittdyna Matrx Libra abduktionskil | 49798 |
| Kil sidostöd sittdyna Matrx Libra lateral kil | 43534 |
| Kil främre sittdyna Matrx Libra används fram | 43535 |
| Gel inlägg sittdyna Matrx Libra påse | 43539 |

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Tryckavlastande och positionerande sittdynor

## 1. Luftfylld dyna utan separat pump

### Avsedd användning

Patienten sitter på dynan större delen av dagen. Patienten kan inte aktivt ändra position i sittande. Patienten behöver individuella anpassningar för att uppnå och bibehålla ett funktionellt sittande. Patienten är tryck- och/eller smärtkänslig. Patienten behöver avlastning av redan befintligt trycksår.

### Egenskaper

Sittdyna som ger god positionering och fördelar tryck över sittytan genom sin form och material. Sittdynan kan anpassas manuellt för att kompensera eller korrigera deformitet eller funktionsbortfall hos patienten, samt kan avlasta tyck på specifik kroppsdel. Sittdynan har nio (9) fack med luftinlägg (SmartCells™). Sittdynan kan användas färdig från förpackning. Handcheck rekommenderas. Avståndet mellan sittbensknöl och sitsbotten ska vara minst 2,5cm.

### Avtalad produkt

Produktnamn:
Vicair Vector O2 10 cm
Leverantör: Invacare AB

### Standardutförande

Sittdyna med luftgenomsläppligt överdrag

### Tillbehör

Inkontinensöverdrag

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring | Rekommendation |
|---|---|---|---|
| 10cm | 250kg | Hela sittdynan tvättas i max 60º C. | Puffa upp dynan varje dag före användning. |

| Sittdyna inkl standardöverdrag | Artikelnr VwS | Artikelnr VwS inkontinensöverdrag |
|---|---|---|
| Sittdyna Vicair Vector O2 35x35x10cm | 43505 | 43272 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 35x40x10cm | 43245 | 43264 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 38x40x10cm | 49776 | 49793 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 38x45x10cm | 49777 | 49794 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 40x40x10cm | 43246 | 43265 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 40x45x10cm | 43247 | 42198 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 43x40x10cm | 49778 | 49795 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 43x45x10cm | 47001 | 47031 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 45x40x10cm | 43248 | 43268 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 45x45x10cm | 43249 | 42584 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 45x50x10cm | 43250 | 43269 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 48x45x10cm | 49779 | 49797 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 50x45x10cm | 43251 | 43270 |
| Sittdyna Vicair Vector O2 50x50x10cm | 49780 | 43271 |

Tillbaka till Innehållsförteckning

## 2. Luftfylld dyna med separat pump

### Avsedd användning

Patienten sitter på dynan större delen av dagen. Patienten kan inte aktivt ändra position i sittande. Patienten behöver individuella anpassningar för att uppnå och bibehålla ett funktionellt sittande. Patienten är tryck- och/eller smärtkänslig. Patienten behöver avlastning för att undvika att trycksår eller smärta uppstår eller för avlastning av redan befintligt trycksår.

### Egenskaper

Sittdyna som ger god positionering och fördelar tryck över sittytan genom sin form och material. Sittdynan kan anpassas manuellt för att kompensera eller korrigera deformitet eller funktionsbortfall hos patienten, samt kan avlasta tyck på specifik kroppsdel. Sittdynan har luftkuddar (ROHO®) i fyra (4) fack. Luften kan regleras med ISOFLO® minnesenhet belägen fram på sittdynan. Utför alltid handcheck. Avståndet mellan sittbensknöl och sitsbotten ska vara mellan 1,5–2,5cm.

### Avtalad produkt

Produktnamn:
ROHO® Quadtro Select
Leverantör: Permobil AB

### Standardutförande

Sittdyna med luftgenomsläppligt
överdrag. Handpump.

### Tillbehör

Inkontinensöverdrag

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring | Rekommendation |
|---|---|---|---|
| 10cm | Obegränsad | Standardöverdrag tvättas i max 60°<br>Dynan tvättas för hand och desinfekteras. | Utför handcheck regelbundet. Atmosfäriskt tryck kan användas som grundinställning om handcheck ej är möjligt (ex smitta). |

Inställning atmosfäriskt tryck (från Permobil):

Tillbaka till Innehållsförteckning

| **Sittdyna inkl standardöverdrag** | **Artikelnr VwS** | **Artikelnr VwS inkontinensöverdrag** |
|---|---|---|
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 7x7 celler **sb 31 - 35cm sdj 31 - 35cm** | 43049 | 43497 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 7x8 celler **sb 31 - 35cm och sdj 35 - 39,5cm** | 33557 | 50055 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 7x9 celler **sb 31 - 35 och sdj 39,5 – 44cm** | 32836 | 43496 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 8x8 celler **sb 35 -39,5 och sdj 35 - 39,5 cm** | 32758 | 45444 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 8x9 celler **sb 35 -39,5 och sdj 39,5 – 44 cm** | 30585 | 43494 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 8x10 celler **sb 35 -39,5 och sdj 44 - 48,5 cm** | 32554 | 43495 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 9x9 celler **sb39,5-44 och sdj 39,5-44 cm** | 30706 | 43490 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 9x10 celler **sb 39,5 - 44 och sdj 44 - 48,5 cm** | 31740 | 43493 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 10x9 celler **sb 44 - 48,5 och sdj 39,5 – 44 cm** | 30734 | 43500 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 10x10 celler **sb 44 - 48,5 och sdj 44 - 48,5 cm** | 32269 | 43504 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 10x11 celler **sb 44 - 48,5 och sdj 48,5 - 53,5 cm** | 32494 | 43503 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 11x10 celler **sb 48,5 - 53,5 och sdj 44 - 48,5 cm** | 32846 | 43499 |
| Sittdyna ROHO Quadtro Select Högprofil 11x11 celler **sb 48,5 - 53,5 och sdj 48,5 - 53,5 cm** | 33036 | 43498 |

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Dyna typ Coxit L1

## Avsedd användning

Patienten har inskränkt rörlighet i höft eller restriktioner gällande höftböjning efter operation. Kan ha behov av coxitläge i en eller båda höfterna.

## Egenskaper

Sittdynan ger coxitläge. Sittdynan är av kallskum och inkluderar luftgenomsläppligt överdrag. Sittdynan är vändbar för att passa höger och vänster ben. Den mjukare delen (Coxit-delen) är av annan färg på skummet och placeras alltid i framkant. Används direkt ur förpackningen.

## Avtalad produkt

Produktnamn:
Nima förhöjningsdyna Coxit
Leverantör: NimaCare AB

| Max brukarvikt | Rengöring | Rekommendation |
|---|---|---|
| 150kg | Överdraget tvättas i 60°C.<br>Skumbas rengörs med ytdesinfektion. | Enpersonsdyna.<br>Rekonditioneras ej. |

| Sittdyna inkl. standardöverdrag | Artikelnr VwS |
|---|---|
| Sittdyna Coxit 1/4 urtag 40x40x7,5cm | 43509 |
| Sittdyna Coxit 1/4 urtag 40x40x10cm | 43510 |
| Sittdyna Coxit 1/2 urtag 40x40x7,5cm | 43511 |
| Sittdyna Coxit 1/2 urtag 40x40x10cm | 43512 |

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Utjämningsskiva

## Avsedd användning

Ska ge en stabil botten för plana sittdynor för att kompensera för hängmatteeffekt i rullstol.

## Egenskaper

Utjämningsskivan är i hård cellplast utan överdrag. Placeras med rundade bakkanten bakåt och fasade undersidan vänd ned. Ingen antiglid finns på utjämningsplattan. Används direkt ur förpackningen.

## Avtalad produkt

Produktnamn:
Curera® Utjämningsplatta
Leverantör: Care of Sweden AB

| Höjd | Max brukarvikt | Rengöring | Rekommendation |
|---|---|---|---|
| 2,5cm | Obegränsad. | Milt rengöringsmedel eller ytdesinfektionsmedel. | Placera innanför dynöverdraget. |

| **Utjämningsplatta utan antiglid** | **Artikelnr VwS** |
|---|---|
| Utjämningsplatta 35x35x2,5 cm | 44618 |
| Utjämningsplatta 35x40x2,5 cm | 43321 |
| Utjämningsplatta 40x40x2,5 cm | 44317 |
| Utjämningsplatta 40x45x2,5 cm | 44619 |
| Utjämningsplatta 45x40x2,5 cm | 44318 |
| Utjämningsplatta 45x45x2,5cm | 43326 |
| Utjämningsplatta 45x50x2,5 cm | 49369 |
| Utjämningsplatta 50x45x2,5 cm | 44620 |
| Utjämningsplatta 50x50x2,5 cm | 43328 |
| Utjämningsplatta 55x50x2,5 cm | 43330 |

OBS! Utjämningsskivor finns i fler storlekar än de som presenteras i vägledningen.

Tillbaka till Innehållsförteckning

# Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Emma Stenborg, arbetsterapeut, Västerviks kommun (Västervik, Vimmerby och Hultsfred)
Ingela Franzén, arbetsterapeut, Mönsterås kommun (Mönsterås, Högsby och Oskarshamn)
Sara Nordendahl, fysioterapeut, Kalmar kommun (Kalmar, Borgholm och Mörbylånga)
Rasmus Reinholdsson, arbetsterapeut, Torsås kommun (Emmaboda, Torsås och Nybro)

Patricia Bengtsson, hjälpmedelskonsulent, KHS
Farah Mahdi, administratör, KHS
Alexandra Didriksson, upphandlare, Västerviks kommun

Vid frågor gällande denna upphandling hänvisas ni till sortimentsgruppen.

Tillbaka till Innehållsförteckning